



# 《AC-015BT 内データをまとめて出力する方法》

手順①～③は《その①》をお読み下さい。



- ⑤ 「Select date」内で検知器内の計測データを  
確認します。

DATE 番号を選択してプリントアウトします。

Date : 計測日

Time: 計測時間



Result : 計測結果

Test NO. : 総合使用回数番号

Date NO. : 計測記録番号

- ⑥ カーソルを「Range」に合わせて、OK します。

数字の上にカーソルを合わせて OK します。





- ⑦ 上下カーソルボタンと OK ボタンで

Date 番号の打ち込みをします。

打ち込み終了して確定しますと

カーソルが数字全域を囲みます






- ⑧ カーソルを下の「NEXT」へ移動させ

OK ボタンを押します。

指定日時分の計測結果がプリントアウト

されます。

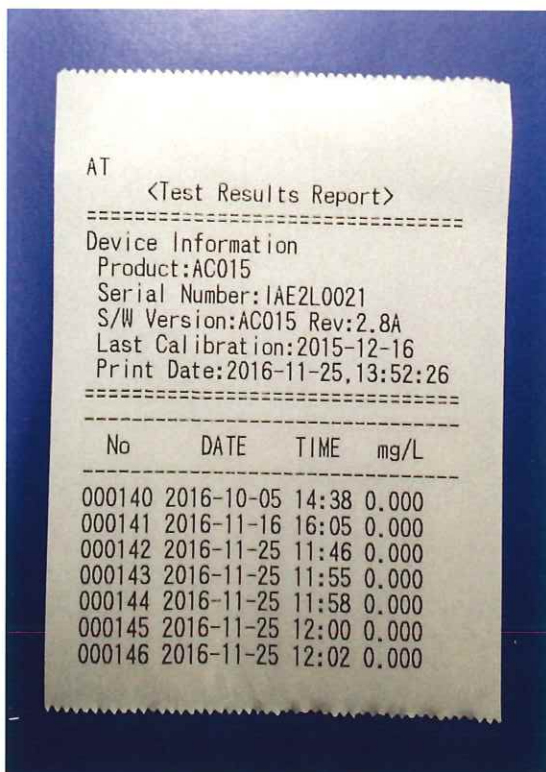

〈計測結果レポート〉

Device Information

Product : AC015

Serial Number : 使用機種番号

S/W Version:AC015 verxxxx

LastClibration: 最終調整日時

Print Date ; プリントアウト日時

計測番号 年月日 時間 計測結果

- ⑨プリントアウト後、カーソルを上へ上へと

移動させて「管理者モード」より

「測定モード」へ移動します。